




Cardiologie

Electrodes, Papiers ECG, Couplants, Piles



Une équipe à votre écoute

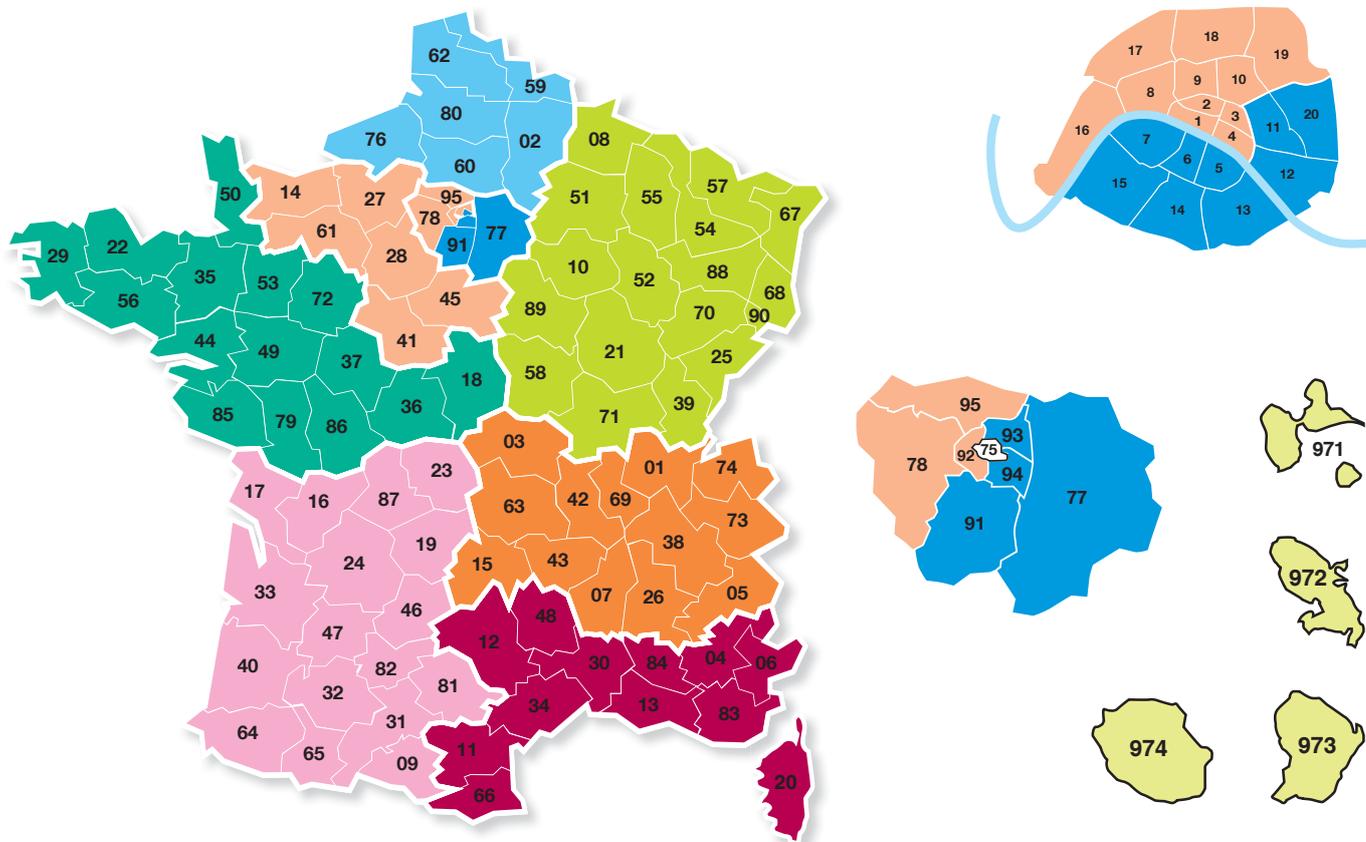

● **Région Nord**
Olivia Deniès
06 72 03 37 22

● **Région Rhône-Alpes**
Florence Ducruet Nesme
07 61 98 09 45

● **Région Sud-Ouest**
Brice Lacoste
06 33 95 66 45

● **Région Est**
Lionel Ponard
06 63 76 09 81

● **Région Centre-Ouest**
François Duvignau
06 42 10 70 27

● **Région PACA**
Jean-Paul Bendayan
06 77 74 60 96

● **Région Île-de-France Est**
Zina Haddadou
06 69 67 88 83

● **Région Île-de-France Ouest**
Freddy Boismoreau
06 69 67 88 75

● **DOM TOM et Export**
Sandrine Bonnafous
01 30 11 83 49

Pour commander



Par courrier

EDM

1, rue des Boisseliers - 95330 DOMONT



Sur Internet

www.edm-imaging.com



Par téléphone

01 30 11 83 00

Du lundi au vendredi

De 9h00 à 18h00 sans interruption



Par fax

01 39 35 75 25

Sommaire

Electrodes p 3

SilverTrace® & Digitrode®

SilverTrace II®

Nutrode® & Nutrace®

Blue sensor®

Electrodes précablées

Défibrillation p 6

Couplants p 7

Piles p 8

Papiers d'enregistrement p 9

Bon de commande EDM p11

Conditions Générales de Vente .. p 12



Découvrez notre toute première
gamme d'électrodes EDM
(en page 5)

D'autres références disponibles.
Contactez nous !



SILVERTRACE® & DIGITRODE®



| Réf. | F55 | F-REC | F-RG | FSRB4 | RT37 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Caract. | Électrode SILVERTRACE P55MO | Électrode SILVERTRACE P28MOC | Électrode SILVERTRACE P28MO | Électrode SILVERTRACE B4MO | Électrode DIGITRODE |
| Support | Mousse | Mousse | Mousse | Mousse | Papier |
| Dimensions | 55 mm | 32 x 44 mm | 32 x 41 mm | 28 x 44 mm | 22 x 34 mm |
| Connecteur | Bouton pression | Bouton pression carbone | Bouton pression | Pontet 4 mm | EASYTAB - Crocodile |
| Type de gel | AQUAWET - Gel liquide | AQUATAC - Hydrogel |
| Adhésif | Standard | Standard | Standard | Amélioré | Standard |
| Utilisation | Diagnostique | Diagnostique, IRM | Diagnostique | Diagnostique | Diagnostique |
| Condt. | Boîte de 300 (10 sachets de 30) | Boîte de 500 (5 sachets de 100) |

Existe en radiotransparent avec bouton pression en carbone (réf. FS-50C)



| Réf. | T55 | T60 | CT601 | F-TC1 | FS50 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Caract. | Électrode SILVERTRACE P55MI | Électrode SILVERTRACE P60MI | Électrode SILVERTRACE P50TR | Électrode SILVERTRACE P20MO | Électrode SILVERTRACE PS50MO |
| Support | Microporeux | Microporeux | Adhésif Cristal | Mousse | Mousse |
| Dimensions | 55 mm | 60 mm | 50 mm | 35 x 41 mm | 50 mm |
| Connecteur | Bouton pression |
| Type de gel | AQUAWET - Gel liquide | AQUAWET - Gel liquide | AQUATAC - Hydrogel | AQUATAC - Hydrogel | AQUAWET - Gel liquide |
| Adhésif | Standard | Standard | Standard | Standard | Amélioré |
| Utilisation | Holter | Holter | Multi usage | Multi usage | Stress Test |
| Condt. | Boîte de 300 (10 sachets de 30) |

SILVERTRACE II®



| Réf. | BW50 | FW50 | FW3650 | FS32 |
|--------------------|---|---|---|--|
| Caract. | Électrode SILVERTRACE II® Ag/AgCl - Adulte | Électrode SILVERTRACE II® Ag/AgCl - Adulte | Électrode SILVERTRACE II® Ag/AgCl - Adulte | Électrode SILVERTRACE II® Ag/AgCl - Adulte/Enfant |
| Support | Microporeux | Mousse | Mousse | Mousse |
| Dimensions | Diam. 50mm | Diam. 50mm | 36 x 50 mm | 32 x 32 mm |
| Connecteur | Bouton pression | Bouton pression | Pontet 4 mm | Bouton pression |
| Type de gel | Gel liquide | Gel liquide | Gel liquide | Gel solide |
| Adhésif | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Utilisation | Holter | Diagnostic | Stress Test | Stress Test |
| Condt. | Boîte de 400 (8 sachets de 50) | Boîte de 400 (8 sachets de 50) | Boîte de 300 (10 sachets de 30) | Boîte de 500 (10 sachets de 50) |

D'autres références disponibles.
Contactez nous !



NUTRODE® & NUTRACE®




| Réf. | 31371308 | 31488177 | 40000020 | 50000044 |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Caract. | Électrode NUTRODE | Électrode NUTRODE | Électrode NUTRODE | Électrode NUTRACE |
| Support | Mousse | Mousse | Mousse | Mousse |
| Dimensions | 35 mm | 30 mm | 34 x 38 mm | 23 x 35 mm |
| Connecteur | Bouton pression | Bouton pression | Bouton pression | EASYTAB - Crocodile |
| Type de gel | HYDROGEL - Gel solide | HYDROGEL - Gel solide | HYDROGEL - Gel solide | HYDROGEL - Gel solide |
| Adhésif | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Utilisation | Diagnostic | Diagnostic | Diagnostic | Diagnostic |
| Condt. | Boîte de 1000 (10 sachets de 100) | Boîte de 1000 (10 sachets de 100) | Boîte de 500 (5 sachets de 100) | Boîte de 1000 (10 sachets de 100) |

BLUE SENSOR®



| Réf. | L-00-S/25 | R-00-S/25 | VL-00-S/25 | N-00-A/25 | N-00-S/25 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Caract. | ELECTRODE BLUE SENSOR |
| Support | Microporeux | PVC | Microporeux | Mousse | Mousse |
| Dimensions | 55 mm | 48 mm | 68 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm |
| Connecteur | Bouton pression | Bouton pression | Bouton pression | Pontet | Bouton pression |
| Type de gel | Gel liquide |
| Adhésif | Standard | Amélioré | Standard | Standard | Standard |
| Utilisation | Holter | Stress Test | Holter | Pédiatrie | Pédiatrie |
| Condt. | Boite de 500 (20 sachets de 25) |

ELECTRODES PRECABLÉES

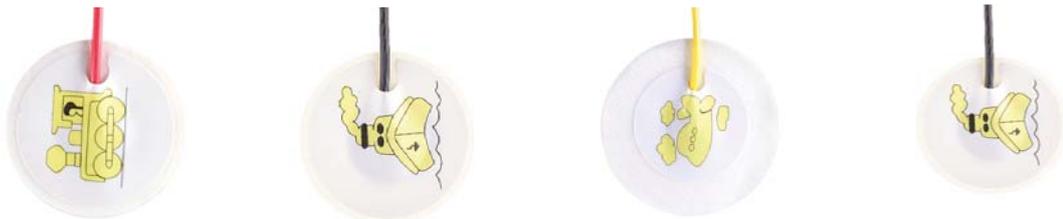

| Réf. | 83068X | 83068XC15 | 87068X | 87068XC15 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Caract. | Electrode précablée | Electrode précablée | Electrode précablée | Electrode précablée |
| Support | Tissus | Tissus | Tissus | Tissus |
| Dimensions | 22 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
| Connecteur | Fiche femelle 4 mm | Fiche DIN 1,55 mm | Fiche femelle 4 mm | Fiche DIN 1,55 mm |
| Type de gel | Prégélifiée repositionnable | Prégélifiée repositionnable | Prégélifiée repositionnable | Prégélifiée repositionnable |
| Adhésif | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
| Utilisation | Pédiatrie et néonatalogie | Pédiatrie et néonatalogie | Pédiatrie et néonatalogie | Pédiatrie et néonatalogie |
| Condt. | Boite de 102 | Boite de 102 | Boite de 102 | Boite de 102 |

ELECTRODES RÉUTILISABLES



| Réf. | F9016SSC | F9008SSC | F9024SSC | F9023SSC | 2A00627 |
|----------------|---|---|---|---|--|
| Caract. | Électrode réutilisable à ventouse précordiale pour adulte 30 mm | Électrode réutilisable à ventouse précordiale pour enfant 15 mm | Électrode pour membres réutilisable pour adulte | Électrode pour membres réutilisable pour enfant | Pince crocodile pour électrode à languette |
| Condt. | Boite de 6 | Boite de 6 | Boite de 4 | Boite de 4 | Unité |





ELECTRODES DE DÉFIBRILLATION

| | |
|--------------------|--|
| Réf. | DF20 |
| Caract. | Electrode de défibrillation pour LIFEPAK 9 / 10 / 12 / 15 / 20 / 500 / 1000 |
| Support | Mousse |
| Dimensions | 113 x 145 mm |
| Connecteur | - |
| Type de gel | Overlapping Gel |
| Adhésif | Standard |
| Utilisation | Défibrillation |
| Condt. | Boite de 20 (10 paires) |



Les électrodes pour autres défibrillateurs sont disponibles sur demande



| Type d'électrode (Réf.) | Connecteur | Compatible avec la suite de défibrillateurs | Longueur de câble |
|-------------------------|---|--|--|
| DF20N |  | Medtronic Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 500 et 1000 | 1,20 m |
| DF20NC |  | | 1,20 m pour pré-connecter 0,45 m câble hors du sachet |
| DF25N |  | Schiller FRED, Schiller FRED Tele, DG1002, DG2002, DG3002, DG2000E, DG2000EDOS | 2,00 m |
| DF26N |  | Philips Codemaster XL, XL+, XE et 100 | 1,20 m |
| DF27N |  | Philips Heartstart FR2+, FR2 et FR3, Heartstream Forerunner, Heartstart MRx, Heartstart XL et XL+ | 1,20m |
| DF27NC |  | | 1,20 m pour pré-connecter 0,45 m câble hors du sachet |
| DF28N |  | Zoll M, E et R Series, PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1700 et PD 2000 | 1,20 m |
| DF28NC |  | | 1,20 m pour pré-connecter 0,45 m câble hors du sachet |
| DF29N |  | Welch Allyn MRL AED 10 et 20, PIC 30, PIC 40 et PIC 50 | 2,00 m |
| DF43N |  | Nihon Kohden TEC-5521, TEC-5531, TEC-7621, TEC-7631, TEC-7721, TEC-7731 avec câble adaptateur JC-755V | 2,00 m |
| DF-59N |  | Zoll AED Plus Zoll AED Pro | 1,20 m |

PARKER SIGNA SPRAY® / SIGNA GEL® SIGNA CREME®



- Gel/crème pour EEG, ECG et défibrillation
- Usage externe uniquement
- Ne tache pas

Spray : Électrolyte hautement conductible sous forme de pulvérisateur économique pour EEG, ECG et défibrillation

| Réf. | Caract. | Condt. |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| SIGNASP | Spray en flacon de 250 ml | 12 |
| SIGNA60 | Gel en tube de 60 ml | 12 |
| SIGNA250 | Gel en tube de 250 ml | Unité |
| 17-05 | Crème ECG en tube de 150 gr | Unité |



PARKER SPECTRA 360®

- Gel de contact pour EEG et ECG
- Solution sans sel ni chlorure

| Réf. | Caract. | Condt. |
|-------------------|------------------------|--------|
| SPECTRA250 | Gel SPECTRA 360 250 gr | Unité |



GEL SKINTACT

- Gel de contact pour EEG, ECG et défibrillation
- Ph : 5.5 - 6.2
- Gel hautement conductible

| Réf. | Caract. | Condt. |
|--------------|-------------------------|--------|
| 58586 | Gel ECG SKINTACT 250 ml | 24 |



GEL NUPREP

Pâte conductrice pour EEG et ECG

- Pâte abrasive et semi-liquide
- Hautement conductible

| Réf. | Caract. | Condt. |
|-----------------|-----------------------|--------|
| GE848358 | Gel ECG NUPREP 114 gr | 3 |



| Modèle | LR06 AA | | LR03 AAA | | LR44 | | LR14 | | LR20 | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Voltage | 1,5V | | 1,5V | | 1,5V | | 1,5V | | 1,5V | |
| Type | Alcaline | | Alcaline | | Alcaline | | Alcaline | | Alcaline | |
| Marque | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC |
| Réf. | 636105 | LR6AD/4P | 636106 | LR03AD/4P | 623055 | LR44L/1BP | 636107 | LR14AD/AP | 636108 | LR20AD/4P |
| Condt. | Boite de 10 | 12 blisters de 4 piles | Boite de 10 | 12 blisters de 4 piles | 10 blisters de 2 piles | 10 blisters de 1 pile | Boite de 12 | 6 blisters de 4 piles | Boite de 12 | 6 blisters de 4 piles |



| Modèle | LR01 | | 6LR61 | | 3LR50 | | LR09 | | 3LR12 | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Voltage | 1,5V | | 9V | | 12V | | 1,5V | | 4,5V | |
| Type | Alcaline | | Alcaline | | Alcaline | | Alcaline | | Alcaline | |
| Marque | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | ENERGIZER | ENERGIZER | ENERGIZER | ENERGIZER | ENERGIZER |
| Réf. | 608306 | LR-1L/1BP | 636109 | 6LR61AD/1P | 608305 | | 623056 | | 632856 | |
| Condt. | 10 blisters de 1 pile | 10 blisters de 1 pile | Boite de 12 | Boite de 12 | Boite de 10 | | Unité | | Boite de 12 | |



| Modèle | CR2450 | | CR2032 | | 2CR5 | | HR6 | | HR3 | |
|----------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Voltage | 3V | | 3V | | 6V | | 1,2V | | 1,2V | |
| Type | Lithium | | Lithium | | Lithium | | Rechargeable | | Rechargeable | |
| Marque | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | ENERGIZER | ENERGIZER | PANASONIC | ENERGIZER | PANASONIC |
| Réf. | 610381 | CR-2450L/1BP | 611326 | CR-2032EP/IB | 628287 | | 635730 | P6P/4BP_1800 | 635177 | P-03P/2BC800 |
| Condt. | Unité | Unité | 10 blisters de 1 pile | 10 blisters de 1 pile | Unité | | 12 Blister de 4 | Blister de 4 | 12 Blister de 4 | Blister de 2 |

Nous vous proposons toute une gamme de papiers ECG Ceux-ci vous garantissent :

- Un strict respect du cahier des charges des constructeurs.
- Un enregistrement conforme et sûr.
- Une conservation dans le temps des enregistrements grâce à un support papier directement et exclusivement approvisionné auprès de fabricants agréés.

Marquage CE en conformité avec l'annexe V, point 3 de la Directive 93/42/CEE.



**Vous recherchez une référence précise? Vous ne disposez que de la référence de votre appareil ?
Vous avez besoin d'un conseil ? 01 30 11 83 08. Une ligne dédiée à vos attentes.**



| Constructeur | Modèle | Code | Papier | Unité | Largeur (mm) | Métrage (m) | Tube (mm) | Diamètre (mm) | Feuilles | Longueur (mm) |
|------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------|--------------|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| AMPLAID | 770 | 700I0104 | 0 | Rouleau | 110 | 25 | 12 | 45 | 0 | 0 |
| COROMETRICS | SERIE 115 | 233P5313 | 4305 BAO | Pliage | 152 | 13 | 0 | 0 | 150 | 90 |
| CRITIKON | PRO 100 | 001I1389 | 89100 | Rouleau | 57 | 22 | 12 | 43 | 0 | 0 |
| DATASCOPE | ACCUTORR | 957I1115 | 0683.00.0447.03 | Rouleau | 57 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| FUKUDA DENSHI | FDX 4510 | 358R6175OR | OP353TE | Rouleau | 210 | 30 | 16 | 50 | 0 | 0 |
| FUKUDA DENSHI | FX 7202 | 358P8120 | OP222TE | Pliage | 110 | 19,6 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| GETINGE | JUMO | 483P7208 | 40002D | Pliage | 120 | 16 | 0 | 0 | 400 | 40 |
| HELLIGE | CARDIOSMART | 414P5777 | 226 166 01 | Pliage | 210 | 45 | 0 | 0 | 150 | 300 |
| HELLIGE | MAC 1200 ST | 414P5245 | 226 166 05 | Pliage | 210 | 44,25 | 0 | 0 | 150 | 295 |
| HELLIGE | MAC 1200 ST | 414P5247 | 226 166 11 (archiviste) | Pliage | 210 | 44,25 | 0 | 0 | 150 | 295 |
| HEWLETT PACKARD | 78351A | 416R5108 | 40457 C | Rouleau | 50 | 30 | 16 | 50 | 0 | 0 |
| HEWLETT PACKARD | 82240B | 416I2011 | 82175A | Rouleau | 57 | 25 | 12 | 45 | 0 | 0 |
| HEWLETT PACKARD | A1 | 416I0477 | M4817A | Rouleau | 50 | 30 | 16 | 50 | 0 | 0 |
| HEWLETT PACKARD | M1350A | 416P5218 | M1911A | Pliage | 150 | 15 | 0 | 0 | 150 | 100 |
| HEWLETT PACKARD | M1350A | 416P7008 | M1911A (archiviste) | Pliage | 150 | 15 | 0 | 0 | 150 | 100 |
| HEWLETT PACKARD | M1702A | 416P5220 | M1709A | Pliage | 210 | 60 | 0 | 0 | 200 | 300 |

| Constructeur | Modèle | Code | Papier | Unité | Largeur (mm) | Métrage (m) | Tube (mm) | Diamètre (mm) | Feuilles | Longueur (mm) |
|----------------|------------------|----------|------------------------|---------|--------------|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| MARQUETTE | CASE 12 | 537P5215 | 9402-020 | Pilage | 215 | 84 | 0 | 0 | 300 | 280 |
| MARQUETTE | CASE 8000 | 537P5217 | 9402-021 | Pilage | 210 | 84 | 0 | 0 | 300 | 280 |
| MARQUETTE | DASH 3000 | 537I0046 | 9402-046 | Rouleau | 50 | 30 | 16 | 50 | 0 | 0 |
| MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 688R6700 | 804700 | Rouleau | 50 | 30 | 16 | 50 | 0 | 0 |
| NEOVENTA | STAR P11 | 641P5111 | CNS 000 005/1 R1B | Pilage | 151 | 15 | 0 | 0 | 150 | 100 |
| NIHON KOHDEN | BSM 2300 | 634P5097 | FQW 50-3-100 | Pilage | 50 | 30 | 0 | 0 | 300 | 100 |
| NIHON KOHDEN | ECG 1350 | 634P7226 | FQW 210-3-140 | Pilage | 210 | 30 | 0 | 0 | 214 | 140 |
| NIHON KOHDEN | ECG 9010 | 634P5088 | FQW 110-2-140 | Pilage | 110 | 21 | 0 | 0 | 150 | 140 |
| NIHON KOHDEN | ECG 9110 | 634P5084 | FQW 210-3-140 | Pilage | 210 | 30 | 0 | 0 | 214 | 140 |
| NIHON KOHDEN | ECG 9320 | 634P7225 | FQW 210-10-295 | Pilage | 210 | 100 | 0 | 0 | 333 | 295 |
| NIPPON COLLIN | BP 88 | 416I2015 | 11704 | Rouleau | 57 | 30 | 12 | 50 | 0 | 0 |
| ODAM BRUKER | MCT8 | 414R9723 | 0 | Rouleau | 50 | 30 | 16 | 50 | 0 | 0 |
| PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 11 | 688R8319 | 805319-05 | Rouleau | 108 | 23 | 23 | 45 | 0 | 0 |
| SCHILLER | ARGUS LCM | 781P5082 | 2.157.026 | Pilage | 80 | 14 | 0 | 0 | 200 | 70 |
| SCHILLER | AT 110 - AT10+ | 781P5078 | 2.157.023 | Pilage | 210 | 35 | 0 | 0 | 250 | 140 |
| SCHILLER | AT1 | 781P5066 | 2.157.014 | Pilage | 90 | 36 | 0 | 0 | 400 | 90 |
| SCHILLER | AT10 | 781P5010 | 2.157.012 | Pilage | 210 | 35 | 0 | 0 | 250 | 140 |
| SCHILLER | AT102 | 781P5080 | 2.157.025 | Pilage | 210 | 48,4 | 0 | 0 | 173 | 280 |
| SCHILLER | AT2 | 781P5071 | 2008 | Pilage | 210 | 60 | 0 | 0 | 216 | 280 |
| SCHILLER | AT60 | 781P5060 | 2.157.010 | Pilage | 210 | 100 | 0 | 0 | 358 | 280 |
| SMI BBC | FUJI | 359P5015 | JD-0008 | Pilage | 114 | 15 | 0 | 0 | 375 | 40 |
| SMI BBC | JUMO | 483R8655 | 737116 | Rouleau | 120 | 16 | 10 | 35 | 0 | 0 |
| SONICAID | CTG MERIDIAN 800 | 821P7665 | 8400-8003 | Pilage | 143 | 45 | 0 | 0 | 300 | 150 |
| SONICAID | CTG MERIDIAN 800 | 821P7666 | 8400-8003 (archiviste) | Pilage | 143 | 45 | 0 | 0 | 300 | 150 |
| ZOLL | SERIE M | 996P8000 | 8000-0300 | Pilage | 90 | 18 | 0 | 0 | 200 | 90 |

Plumes et encres disponibles

Pour toutes les machines mentionnées ci-dessus



Rouge, Bleu, Vert, Violet et Noir



Conditions générales de Vente

1. GENERALITES

Les présentes Conditions générales de vente visent à définir les droits et obligations de la société EDM Imaging (ci-après le «Vendeur») vis à vis de ses clients (ci-après le «Client» ou «l'Acheteur») dans le cadre de la vente de produits ou services. Ces conditions ne concernent pas les consommateurs et utilisateurs non professionnels, pour lesquels existent des conditions particulières de vente fournies sur demande.

2. COMMANDES

Toute commande vaut acceptation sans réserve de la part de l'Acheteur, des clauses et conditions suivantes, et, le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande, auxquelles il ne peut être dérogé que par accord écrit des parties. Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions ci-après, et pour un minimum de commande de 50 EHT. Toutes spécifications générales ou particulières mentionnées dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'Acheteur, contrairement en tout ou partie aux présentes conditions générales de vente, seront inopposables au Vendeur, sauf accord express et écrit de sa part.

3. FORMATION DU CONTRAT

Le contrat d'achat, de vente et de services est réputé formé entre les parties dans les termes des présentes conditions générales, après réception d'une commande écrite (par télécopie, courrier électronique ou autre) et acceptation de ladite commande par le Vendeur. L'acceptation de la commande par le Vendeur sera réputée acquise à défaut de refus de celle-ci dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, ou en cas d'exécution de la commande dans ce délai. En cas de nécessité d'établir un devis, le contrat ne sera formé qu'après acceptation de celui-ci par le Client.

4. REDACTION DES COMMANDES

Les commandes devront se reporter aux références et désignations des catalogues du Vendeur. Dans le cas d'une erreur de livraison par suite d'une imprécision ou d'une erreur dans les références de la commande, le Vendeur sera déchargé de toute responsabilité, les frais de retour des marchandises vendues étant à la charge de l'Acheteur.

5. EXECUTION DES COMMANDES

Le fait pour un article quelconque de figurer sur les tarifs du Vendeur n'implique pas que les fabricants soient en mesure d'alimenter son stock et ne vaut pas engagement de livrer à la commande. En conséquence, les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'Acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, de réclamer des dommages et intérêts ou une indemnité, de réduire, de différer ou fractionner un paiement. Les délais d'expédition, d'installation, de mise en route ou d'intervention sont purement indicatifs et ne constituent pas une obligation à la charge du Vendeur. Les réclamations à raison de non conformité de la livraison au bon de commande doivent être signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Vendeur et au transporteur dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception des marchandises. Passé ce délai, le destinataire sera réputé avoir accepté définitivement les marchandises et devra en payer le prix ou le loyer. La non exécution ou l'exécution partielle d'une commande, n'ouvrira droit à aucune indemnité au profit de l'Acheteur. En cas de rupture de stock, le Vendeur se réserve le droit de différer toute commande et d'en informer le Client par tout moyen, même téléphonique. Dans tous les cas, le client accepte le délai d'un différé et peut être informé du délai de livraison sur simple appel téléphonique.

6. DOCUMENTATION

Les indications et illustrations du catalogue et du tarif sont indicatives et représentatives des appareils tels qu'ils se présentent au moment de sa publication. Le Vendeur se réserve le droit de livrer des appareils avec toutes modifications extérieures et/ou techniques, en fonction de l'évolution des fabrications et/ou des nouvelles méthodes de construction desdits appareils.

7. ASSURANCE ET TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix de transport, franco ou port dû. **Livraison en France Métropolitaine** : les commandes inférieures à un montant de 209 € H.T impliquent une majoration pour frais administratifs. En cas de manquant ou d'avarie des marchandises à l'arrivée, le destinataire doit : - porter sur le récépissé du transport ses réserves, en précisant exactement la nature de celles-ci, le (les) colis ou marchandises manquants ou détériorés et, de façon générale, l'objet de la réclamation, - confirmer ces réserves au transporteur dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison, par lettre R.A.R., avec copie au vendeur, en précisant les références de la commande (Cf. art L. 133-3 du Code de Commerce). En cas de non respect des stipulations ci-dessus, l'Acheteur sera déchu de tout droit à réclamation.

8. RETOUR

Aucun retour de matériel n'ayant fait l'objet d'un accord écrit et préalable de la part du Vendeur ne sera accepté. Tout retour devra être accompagné d'un bordereau de retour, faisant référence à la facture et au bon de livraison d'origine, et comporter clairement les motifs du retour. Les fabrications spéciales ne seront pas reprises.

9. PRIX

Le prix applicable est le prix figurant sur le tarif en vigueur au moment de la commande. Les prix du tarif en vigueur sont établis suivant les conditions économiques et fiscales au moment de leur établissement. Ils sont susceptibles de modifications sans préavis en cours d'année. Si la commande nécessite l'établissement d'un devis, le prix indiqué sur le devis est valable pendant une durée de 30 jours à compter de sa date. Le prix de transport des produits est suscrit en sus.

10. REGLEMENTS

Les consommables et accessoires sont payables comptant à la commande, avant toute expédition. Les équipements font l'objet d'un acompte à la commande de 30%. Sauf accord écrit particulier, tous les paiements doivent être effectués à réception de facture soit par chèque barré, par virement ou par prélèvement. L'acceptation de traites ne constitue ni novation, ni dérogation à cette clause, non plus qu'à l'attribution de juridiction prévue à l'article 21. En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit du prix de vente taxable, toute autre remise éventuellement déduite. Le montant de la T.V.A déductible par l'acheteur devra venir en déduction du montant de celle afférente à l'escompte. Tout retard de règlement entraînera automatiquement une pénalité correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal, sans mise en demeure préalable, ni formalités spécifiques à accomplir par le Vendeur. En cas de retard de paiement, les ordres en cours pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de tous autres recours. Toute réclamation des sommes dues, envoyée en recommandé A.R sera considérée comme une mise en demeure préalable à toute mesure d'exécution. Les réclamations relatives à la facturation devront parvenir au Vendeur dans les 10 jours suivant la réception de la facture. A défaut, celle-ci sera présumée acceptée sans réserves. Le non respect d'une échéance de paiement à bonne date entraînera la déchéance de tous termes éventuels de paiement, l'exigibilité immédiate de toutes les créances en cours, ainsi que la suspension de toutes commandes et le refus de tous nouveaux ordres d'achat. Le Vendeur, pendant la durée de l'impayé, sera déchargé de ses obligations de faire ou de livrer. En cas de non paiement, les escomptes, délais, ristournes, remises et autres avantages accordés par le Vendeur seront annulés sans que cela préjudicie à la validité des contrats en cours.

11. RESOLUTION DU CONTRAT

Si le Client renonce à sa commande, le contrat se trouvera résolu de plein droit et tout acompte restera acquis au Vendeur, à titre d'indemnité.

12. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (Loi n° 80.335 du 12 Mai 1980)

Il est expressément stipulé que le Vendeur demeure propriétaire du matériel ou marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix de vente par l'acheteur, conformément à la législation en vigueur. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme moyens de paiement qu'après encaissement effectif. Dans le cas de livraisons fractionnées, les marchandises se trouvant encore en possession de l'acheteur seront présumées être celles encore non payées.

En cas de non paiement, le Vendeur pourra conserver les marchandises encore en sa possession et reprendre celles déjà livrées, en quelque endroit qu'elles se trouvent, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts pour inexécution totale ou partielle du paiement du prix. La garde et les risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur dès la livraison et pendant toute la durée de réserve de propriété au bénéfice du Vendeur. L'acheteur assurera les marchandises au profit de qui il appartiendra, contre tous les risques qu'elles pourraient courir ou occasionner dès leur livraison. Tant que la clause de réserve de propriété produit effet, toute vente ou transformation de la marchandise concernée est strictement interdite en référence à l'article 1142 du Code Civil, à l'exception des opérations relevant de l'activité courante de l'acheteur. L'acheteur informera le Vendeur de toute livraison à des tiers de façon à ce que le Vendeur puisse exercer son droit de suite sur la marchandise en quelques mains qu'elle se trouve. De même, l'acheteur informera le tiers auquel il pourrait lui-même remettre la marchandise de l'existence de la clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Au cas où le Vendeur serait amené à faire jouer la clause de réserve de propriété, les sommes éventuellement déjà versées par l'acheteur resteraient acquises au Vendeur à titre de premier dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement le Vendeur. Lorsque le vendeur installe un matériel au profit d'un tiers intervenant (Société de financement, crédit-bail, location, etc....) il est de convention expresse que les clauses prévues aux paragraphes ci-dessus demeurent acquises au bénéfice du Vendeur jusqu'à constatation du règlement intégral des montants par le tiers intervenant, date à laquelle s'effectuera le transfert de propriété.

13. CLAUSE RESOLUTOIRE OU EXECUTION FORCEE

Faute par le Client de respecter les présentes conditions générales de vente, et en particulier de ne pas payer le prix exigible, il sera loisible au Vendeur, soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, soit d'adresser au client une mise en demeure par lettre recommandée avec A.R, mentionnant sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire ou de la déchéance des termes. La vente sera résolue de plein droit, si 8 jours après réception de la mise en demeure, l'obligation d'exécuter les présentes conditions générales ou toutes conditions particulières n'est pas respectée par le Client, ou si le règlement exigible n'est pas intervenu. Le Vendeur pourra rentrer en possession de la marchandise par toute voie de droit.

14. CLAUSE PENALE

En cas de mise en œuvre de la clause résolutoire, toute somme perçue restera acquise définitivement au Vendeur à titre de clause pénale, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. En cas de recouvrement de sa créance sur le client par voie contentieuse, les sommes dues seront majorées de 15% à titre de pénalité, outre les frais judiciaires et intérêts légaux contractuels.

15. MATERIEL EN LOCATION OU MIS A DISPOSITION

Le matériel en location, prêté ou mis à disposition est utilisé sous la seule responsabilité du locataire ou du détenteur gardien, qui devra en assurer l'entretien et l'assurance, et devra être restitué en bon état en fin de contrat. Toute remise en état rendue nécessaire par une utilisation non conforme, ou par dégradation non imputable à l'usage normal, sera à la charge du locataire ou du détenteur. Tout déplacement, toute intervention sur le matériel devront être effectués par un personnel agréé par le Vendeur, et sur l'autorisation écrite préalable du vendeur. A défaut, le locataire ou le gardien seront responsables de toutes les conséquences d'une mauvaise intervention ou manipulation. Le locataire ou le détenteur s'interdit toute sous-location, concession d'usage, prêt ou autre, sous quelque forme que ce soit, sous peine de résiliation si bon semble au Vendeur et sans préjudice de tous dommages et intérêts.

16. GARANTIE DES PRODUITS

En ce qui concerne les consommables, ils sont garantis jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage sauf cas d'utilisation anormale. La garantie du Vendeur est limitée au remplacement des consommables reconnus défectueux ou comportant un défaut de fabrication, d'étiquetage ou d'emballage, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice. Pour du matériel neuf, cette garantie est valable pendant une période de 12 mois, sauf précision différente sur le devis, pour tout vice de fabrication, à compter de la date de livraison, considérée comme date de mise à disposition de l'acheteur. Pour du matériel d'occasion, la durée de garantie est définie dans le contrat de vente spécifique au matériel concerné. L'acheteur devra informer le Vendeur par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les trente jours de la livraison, de tout vice de fabrication ou défaut éventuel. Dans le cas d'un équipement comprenant des composants informatiques, toute modification ou ajout de logiciels sans accord préalable du Vendeur, mettra fin à la garantie. En aucun cas, le Vendeur n'aura à verser une compensation à l'acheteur du fait de la privation de jouissance du matériel qui se serait révélé défectueux, quelle que soit la durée nécessaire à sa réparation ou à son remplacement ou de tout autre dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit. De même, l'acheteur ne pourra exiger le remboursement du matériel qui se serait révélé défectueux, sauf accord écrit du Vendeur constatant qu'il ne peut être ni réparé ni remplacé. Le remplacement est effectué en marchandises ou pièces vierges identiques ou comparables et en même nombre et type que celles commandées à l'origine. La garantie ou les assurances constructeur accordées par le Vendeur ne s'appliquent que si les produits ou matériels sont utilisés selon les normes applicables à la technologie considérée, en conformité avec les préconisations d'usage ou d'emploi et en l'absence d'intervention de toute personne non habilitée par le Vendeur. Les stipulations des présentes ne sauraient faire échec aux obligations de garantie légale incombant au fabricant. La garantie ne s'applique pas aux fusibles et lampes.

17. RESPECT DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE

Les Produits sont conformes à la législation française en vigueur au jour où le Vendeur les commercialise. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée en cas de défaut de respect de la législation du pays dans lequel les Produits sont livrés, qu'il appartienne au Client de vérifier. Nonobstant ce qui précède, le Vendeur sera en droit d'annuler une commande s'il existe un doute sur le respect de la législation du pays de livraison.

18. LIMITATION DE RESPONSABILITE

La responsabilité du Vendeur au titre de la fourniture des produits et services ne couvrira pas les dommages indirects subis par l'acheteur, tels que les pertes d'exploitation ou de revenus. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur sera limitée au prix de facturation des produits ou services mis en cause par le Client. Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers au delà des exclusions et limites exposées ci-dessus.

19. ENVIRONNEMENT

Il appartient au Client de vérifier le régime juridique en matière environnementale des produits dont il fait l'acquisition et de respecter les obligations qui lui incombent quant à l'élimination des déchets. Dans l'hypothèse où les produits seraient concernés par le décret 2005-829 du 20 juillet 2005, ou toute législation subséquente prévoyant des obligations similaires, le Client prendra à sa charge la collecte des produits, leur traitement ainsi que leur valorisation.

20. MARQUES-MENTIONS

Toute mention ou utilisation de marques, noms, sigles, logos, couleurs, graphismes ou autre, appartenant à, ou déposés par le Vendeur ou par le fabricant, sur quelque support que ce soit et quelles qu'en soient l'utilisation et la destination, ainsi que toute modification des emballages d'origine, ou de mentions portées sur les emballages ou les produits, doivent être soumises à l'approbation préalable et écrite du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit d'exiger le retour de ses articles, documents, mobiliers publicitaires ou autres et d'interdire la diffusion de textes ou produits reprenant ses noms, marques déposées ou autres, ou celles du fabricant, chaque fois que l'utilisation qui en sera faite lui apparaîtra de mauvaise foi, sujette à tromper le consommateur ou contraire au bon renom du Vendeur. Le tout sans préjudice de résiliations, dommages et intérêts ou autres indemnités en cas de non respect de la présente clause par le Client.

21. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les tribunaux du lieu du siège social du Vendeur sont seuls compétents pour connaître des contestations pouvant naître à quelque titre que ce soit des présentes Conditions Générales et des contrats auxquels elles s'appliqueront. Il en est de même en cas de demande incidente, d'appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs. Le droit français, à l'exclusion de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises, sera applicable.

Découvrez toute notre offre !

Gratuitement sur demande

**N'hésitez-pas à nous
contacter !**



Catalogue désinfection



Catalogue général EDM



Echographie
Protections pour sondes
d'échographie



Radioprotection
Praticiens, Patients
et locaux



**Housses de protection
en milieu opératoire**



Imagerie Médicale
Impression, stockage
et archivage

>> Téléchargeables sur www.edm-imaging.com/catalogues.html



Le médical à votre image

EDM

1, rue des Boisseliers
95330 Domont

Tél. : + 33 (0)1 30 11 83 00
Fax : + 33 (0)1 39 35 75 25

www.edm-imaging.com

(V02-2017)

